



TROUSSE POUR RETIRER LES IMPLANTS GEN II MODERNISATION

MODERNISEZ VOTRE TROUSSE
AVEC LA TROUSSE DE
CONVERSION « GEN II »

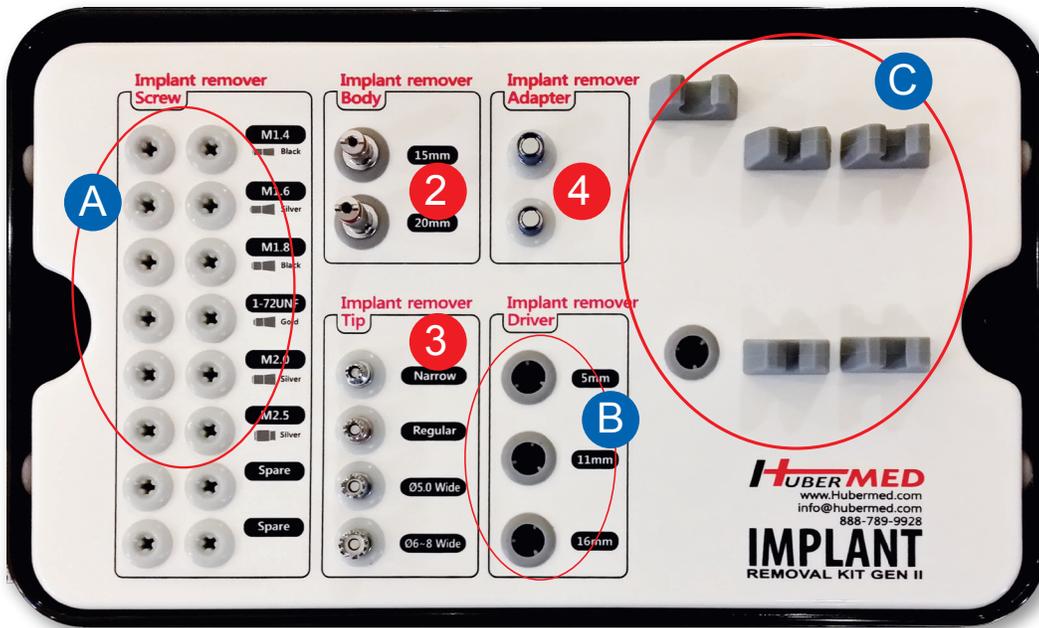

TROUSSE DE LA 1^{ERE} GÉNÉRATION

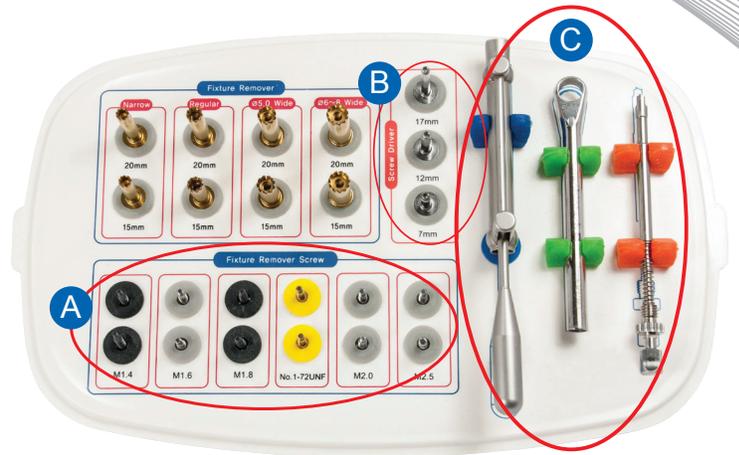

INCLUS :

1. Plateau refermable
2. Corps Implant Remover x2
3. Embouts Implant Remover x4
4. Adaptateurs Implant Remover x2

- A. Transférer les vis de la trousse antérieure
- B. Transférer les driver de la trousse antérieure
- C. Transférer la clé de torque de la trousse antérieure

Les vis pour retirer les implants
sont spécifiquement identifiées dans la liste de compatibilité suivante :
http://hubermed.com/media/ImplantRemovalKit_Compatibility_List.pdf

Vis pour retirer les implants	Taille des vis	Code de produit
	M 1.4	IRS 14
	M 1.54*	IRS 154
	M 1.6	IRS 16
	M 1.8	IRS 18
	No 1-72 UNF	IRS 172
	M 2.0	IRS 20
	M 2.5	IRS 25

*M 1.54 disponible exclusivement chez Hubermed

Pour commander en ligne
ou pour plus d'information

HUBERMED
1-888-789-9928
info@hubermed.com
www.hubermed.com

Offert en paquet pratique de 2

À USAGE UNIQUE : NE PAS RÉUTILISER. RISQUE DE FRACTURE DE LA VIS LORS DE LA PROCÉDURE DE RETRAIT D'IMPLANT.